

ICHS-LP-015/2019
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO ICHS-LP-015/2019, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN A GAS ÓXIDO DE ETILENO CON EQUIPOS EN COMODATO, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 09:00 horas, del día 11 (once) de abril de 2019, hora y fecha señalada en las bases de la licitación identificada con el numero **ICHS-LP-015/2019**, con fundamento en el artículo 57, 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, para la realización de las aclaraciones de los documentos, requisitos, especificaciones y, en general sobre cualquier punto relativo a la interpretación de las bases, convocatoria o descripción de los bienes de esta licitación, constituidos en la sala de juntas de la Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicada en Calle Tercera No. 604, planta baja, Colonia Centro, se procede por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud a hacer constar que en este acto comparecen, por sí o debidamente representados, los integrantes del mismo, dando por ende curso al desarrollo del presente acto haciendo constar que al mismo comparece el siguiente participante:

1. MOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.

No habiendo aclaraciones que realizar por parte de la convocante, se procede a recibir y dar respuesta a las dudas, aclaraciones o preguntas de los participantes.

Este acto es presidido por la Lic. María de Lourdes Blanco Alarcón, suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud, quien al inicio comunica que de conformidad con el artículo 59 fracciones III y IV de la Ley de la Materia, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria y bases de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación Pública, a través de los correos electrónicos adquisiciones.ichisal@chihuahua.gob.mx; brenda.baca@chihuahua.gob.mx y/o personalmente en las oficinas que ocupa la Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud por si o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

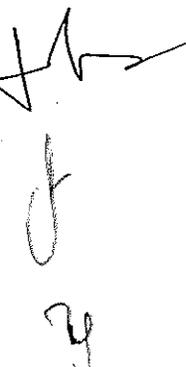

La suplente del presidente dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 59 fracciones III y IV de la Ley de la Materia, solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar en el mismo a través de correo electrónico y/o personalmente, del licitante:

1. **MOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.**, por medio de correo electrónico y de acuerdo con la persona que acude a este acto, manifiesta tener las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1: Relativo al ANEXO 6 PROPUESTA TECNICA. CONCEPTO 6. Se les solicita atentamente a la convocante nos confirme si lo que requiere es cartucho con 170 gramos de gas óxido de Etileno que es compatible con la capacidad de la cámara que solicitan, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: El insumo requerido para el concepto 6 de la partida única es un cartucho de gas de óxido de etileno, compatible con las características y de acuerdo a la capacidad del equipo que se oferte en comodato.

PREGUNTA 2: Relativo al ANEXO 6 PROPUESTA TECNICA. CONCEPTO 7. Se le solicita atentamente a la convocante nos confirme si lo que requiere son indicadores químicos multiparámetro que permiten llevar el control de los paquetes esterilizados con óxido de etileno a través del cambio gradual de color caja con 240 piezas, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, sin ser limitativa.

PREGUNTA 3: Relativo al ANEXO 6 PROPUESTA TECNICA. CONCEPTO 9. Se le solicita atentamente a la convocante nos confirme si lo que necesita son indicadores biológicos de lectura rápida de 4 horas para gas óxido de etileno en contenedor de polipropileno flexible, contiene una tira de esporas bacillus atrophaeus en un vial flexible de propileno que contiene filtro hidrofóbico que actúa como barrera permeable antimicrobiana, compatible con los autolectores actualmente instalados, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: El insumo requerido para el concepto 9 de la partida única son indicadores biológicos de lectura rápida para gas de óxido de etileno, compatibles con el auto lector que se oferte en comodato.

PREGUNTA 4: Relativo a la DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, numeral 16. Es correcto entender en lo escrito "la naturaleza que son motivo de esta licitación" para comprobar experiencia de las operaciones, que se deben de entregar copias de

facturas y/o contratos, los cuales deben de contener específicamente productos para esterilización a gas descritos en el detalle del anexo 6 en esta convocatoria. ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Se deberá sujetar a lo dispuesto en el punto 16 del numeral 13, inciso A) de las bases del presente procedimiento.

PREGUNTA 5: Relativo al Anexo número 6. Se solicita respetuosamente a la convocante especifique las cantidades por insumo de esterilización que debe de contener cada carga.

RESPUESTA: En este acto se hace entrega a los licitantes asistentes del documento que contiene las cantidades de los insumos que deberán contener cada carga, mismo que forma parte integrante de la presente acta.


Por medio de la persona que asiste, manifiesta no tener más preguntas.

Las presentes aclaraciones a las bases para la licitación identificada con el número **ICHS-LP-015/2019**, tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes en la misma, aún y cuando no hayan comparecido a la presente junta de aclaraciones, debiendo considerar lo aquí asentado para la elaboración de sus propuestas.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley de la Materia, esta acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación. Para efectos de notificación personal, se informa que a partir de esta fecha se fijará en los estrados y en un lugar visible, en el Instituto Chihuahuense de Salud, ubicado en Calle Tercera No. 604, planta baja, Colonia Centro, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada esta primera y última junta de aclaraciones y firman el presente documento en cada una de sus hojas, las personas que intervinieron en el acto el día de su fecha y así quisieron hacerlo, haciéndose entrega de copia de la misma a cada uno de los presentes.

POR EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

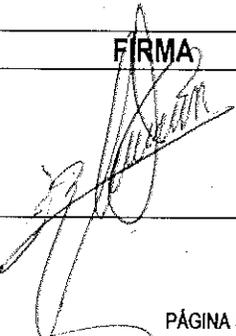NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA DE LOURDES BLANCO ALARCON	SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto Chihuahuense de Salud
Departamento de Adquisiciones y
Recursos Materiales

DR. VITTORIO HUMBERTO VIGNA LLAMAS	DIRECTOR MÉDICO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Y VOCAL DEL COMITÉ	
C.P. RODOLFO CRUZ SÁNCHEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. JUAN DE DIOS EDWIN GARCIA FERNANDEZ	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y VOCAL DEL COMITE	

POR LOS LICITANTES

Razón Social	Nombre	Firma
MOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA PANGEL	

-----FIN DEL ACTA-----



SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

11 de abril de 2019

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL ICHS-LP-015/2019, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN A GAS ÓXIDO DE ETILENO CON EQUIPOS EN COMODATO, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.

NOMBRE DEL LICITANTE (EN CASO DE SER PERSONA MORAL ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO, INCLUYENDO RAZÓN SOCIAL)	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
MOPER MEDICAL SA DE CV	JAVIER GARCIA RINGEL 	javier.garcia@mopermedical.com	614 33627821
JM MEXICO OYENTE	RAFAEL CARROZZA M 	rcaudora.martinez@mm.com	656 6268143